

REPOUSO / POSTO DE ENFERMAGEM

REPOUSO é a terminologia mais informal para **SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA**. Quando houver a necessidade da **ÁREA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS**, esta também ocorrerá neste mesmo REPOUSO.

POSTO DE ENFERMAGEM / SERVIÇOS é área de apoio próxima e diretamente ligada ao REPOUSO.

Ressonância magnética		
Área de detecção de metais		A depender do equipamento utilizado
Sala de indução e recuperação anestésica	A depender dos tipos de exames realizados. Deve de existir quando houver atendimento pediátrico	Distância entre leito(s) igual à 0,8 m e entre leito(s) e paredes, exceto cabeceira, igual à 0,6 m e com espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa.
Sala de exames de ressonância magnética	1. O nº de salas depende da capacidade de produção do equipamento e da demanda de exames do estabelecimento	ADE, com distâncias mínimas entre as bordas ou extremidades do equipamento e todas as paredes da sala igual a: - 1,0 m das bordas laterais da mesa de exame do equip.; - 0,6 m das demais bordas ou extremidades do equipamento.
Área de comando	1 para cada sala de exames. Uma sala pode servir à 2 salas de exames	6,0 m ²
Área para atendimentos de emergências	1. Opcional caso exista a sala de recuperação anestésica	6,0 m ²
Posto de enfermagem e serviços		6,0 m ²


REPOUSO / POSTO DE ENFERMAGEM

SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA + POSTO DE ENFERMAGEM / SERVIÇOS = 25m² a 50m²

1 leito de repouso para cada 2 exames (mínimo). Ideal é 1 leito por exame.

Tomografia¹		
Sala de exames de tomografia	1. O nº de salas depende da capacidade de produção do equipamento e da demanda de exames do estabelecimento	ADE, com distâncias mínimas entre as bordas ou extremidades do equipamento e todas as paredes da sala igual a: - 1,0 m das bordas laterais da mesa de exame do equip.; - 0,6 m das demais bordas ou extremidades do equipamento.
Área de comando	1 para cada sala de exames. Uma sala pode servir à 2 salas de exames	6,0 m ²
Sala de indução e recuperação anestésica	A depender dos tipos de exames realizados. Deve existir quando houver atendimento pediátrico	Distância entre leito(s) igual à 0,8 m e entre leito(s) e paredes, exceto cabeceira, igual à 0,6 m e com espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa
Posto de enfermagem e serviços		4,5 m ²

****Qualquer exame que possua anestesia, devemos prever uma área de recuperação
Ex: ultrassonografia com biópsia

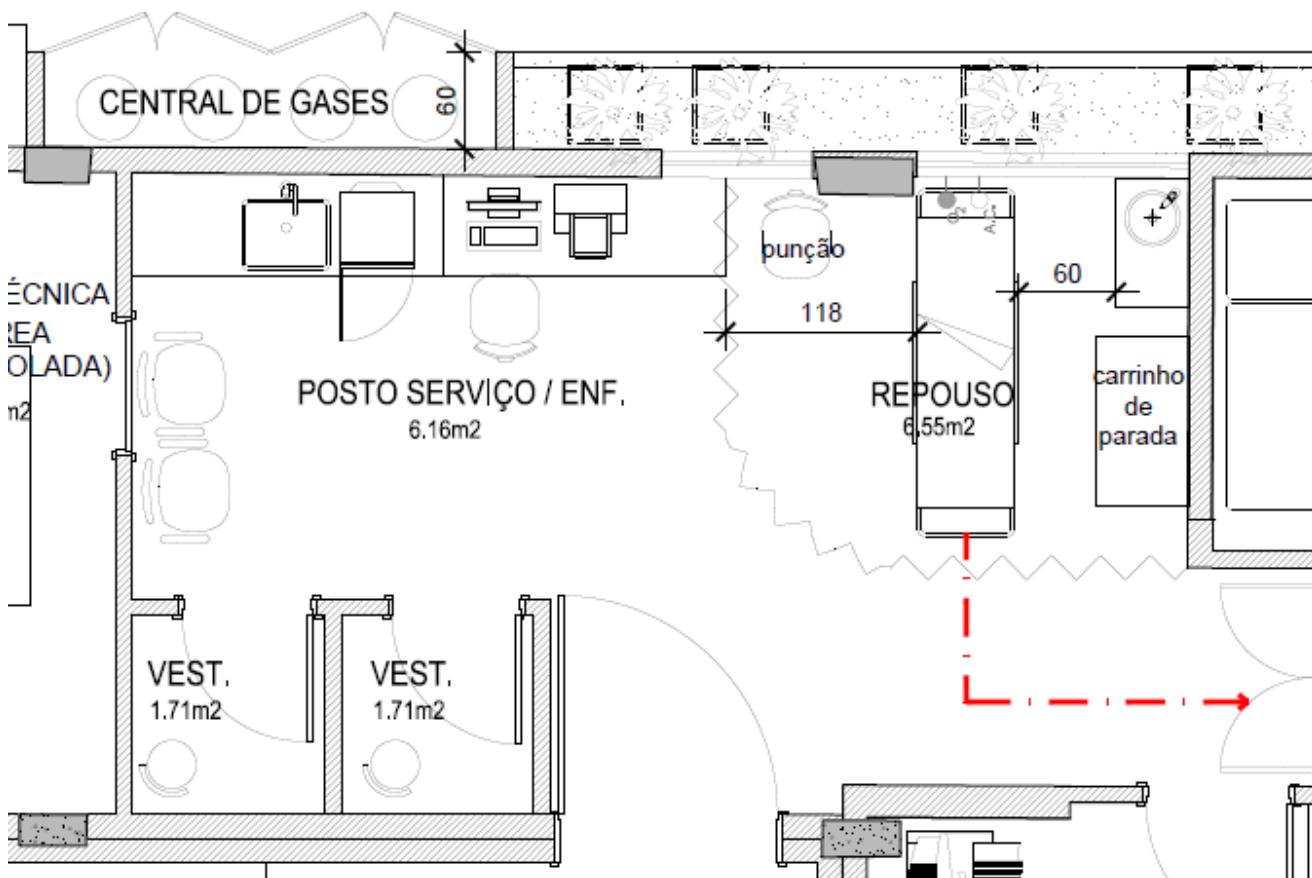

REPOUSO / POSTO DE ENFERMAGEM (27m²)

Espera de 2/3 lugares

2 cabines de vestiários

1 maca (somente 1 exame)

Posto de enfermagem/serviços


Área para punção

Saída de emergência

CENTRAL DE GASES MEDICINAIS:


Área onde ficam os cilindros dos gases medicinais (de preferência em área externa), com portas venezianas.

Os pontos localizam-se dentro das salas de exames e nos repousos.

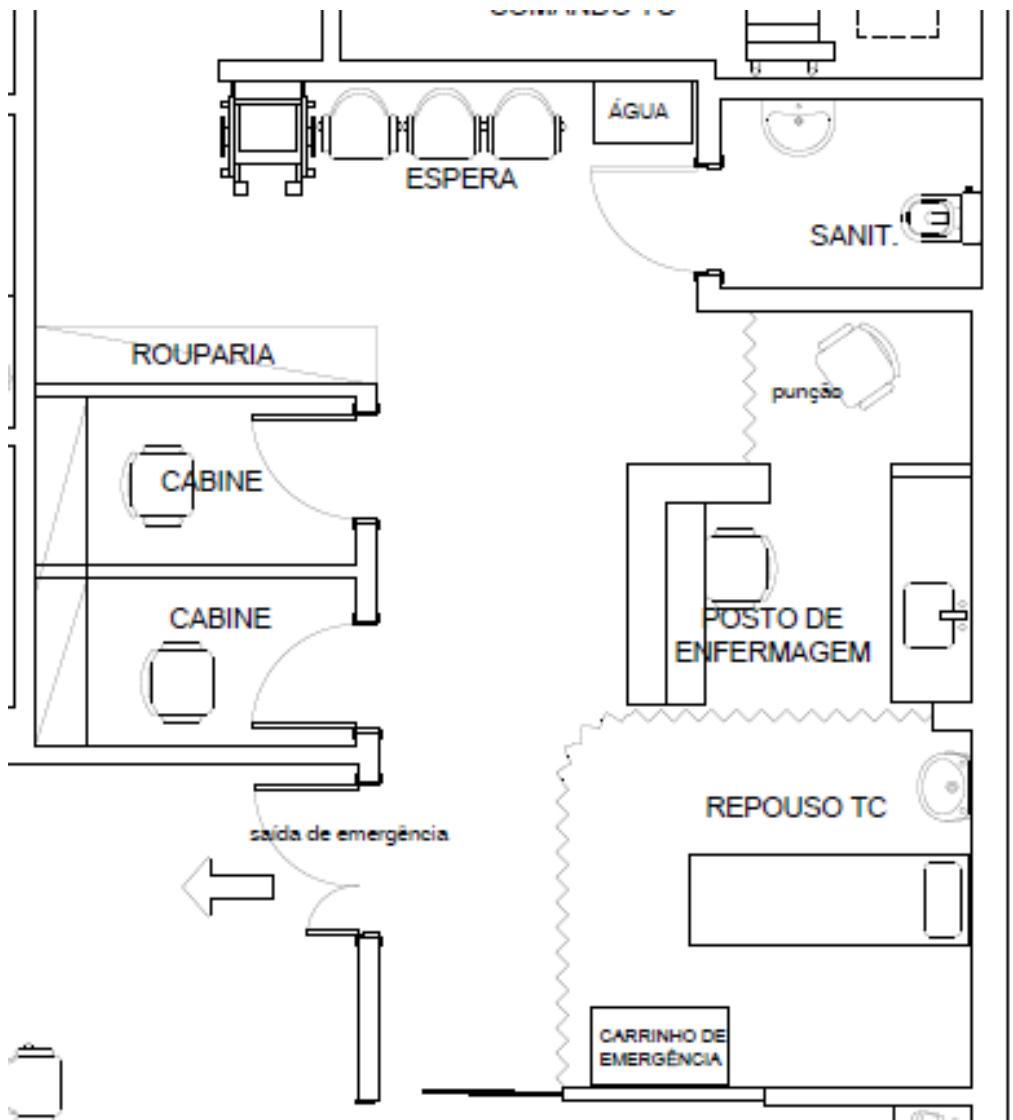

REPOUSO / POSTO DE ENFERMAGEM (47m²)

Espera de 2/3 lugares
 2 cabines de vestiários
 1 maca (somente 1 exame)
 Posto de enfermagem/serviços
 Área para punção
 Rouparia
 Sanitário
 Saída de emergência

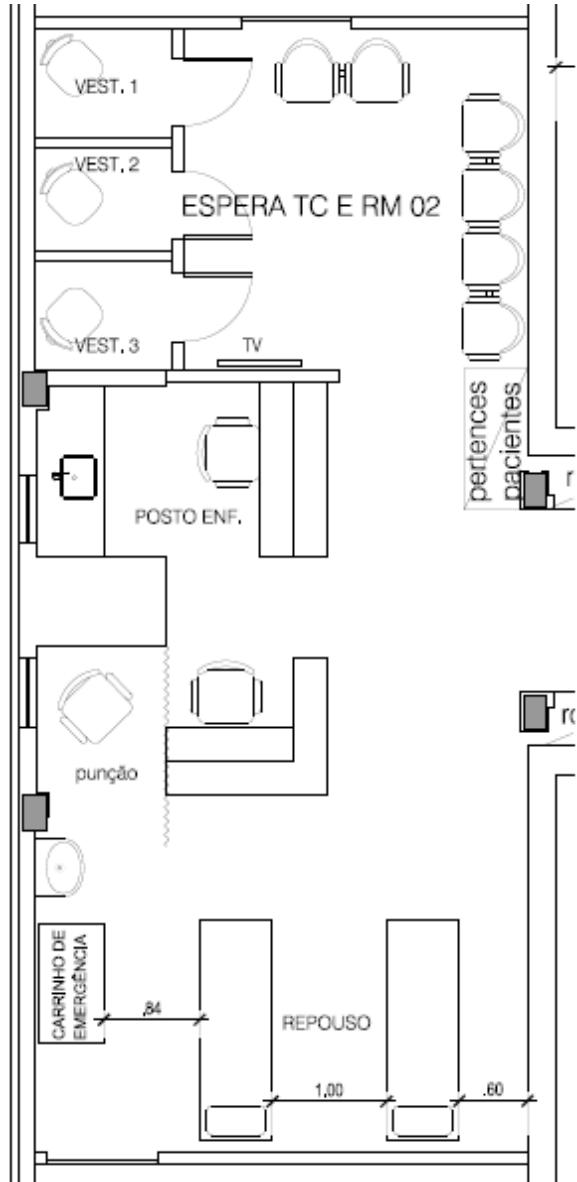

REPOUSO / POSTO DE ENFERMAGEM (43m²)

Espera de 6 lugares
3 cabines de vestiários
2 maca (são 3 exames)
Posto de enfermagem/serviços
Área para punção
Rouparia (circulação)
Saída de emergência

AFASTAMENTO ENTRE MACAS: 0,80 a 1,0m
AFASTAMENTE PAREDE/MACA: 0,60m